

ご案内

IPライン デュオ「ノロ・ロタ」

抽出液容器及び綿棒包装形態の変更について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度利便性向上の為、抽出液容器・試料ろ過フィルター及び綿棒包装形態の変更を行いますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、製品性能及び品質に関しましては変更ございません。


引き続きご愛用のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白


記

■抽出液容器及び試料ろ過フィルターの変更

使用時の利便性を考慮して、抽出液容器及び試料ろ過フィルターを変更しました。

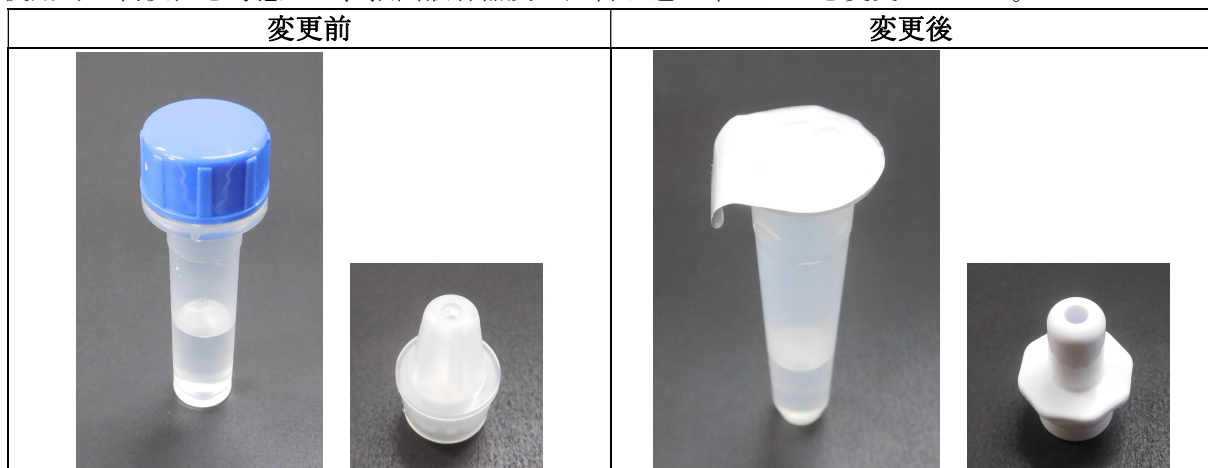

◆操作方法

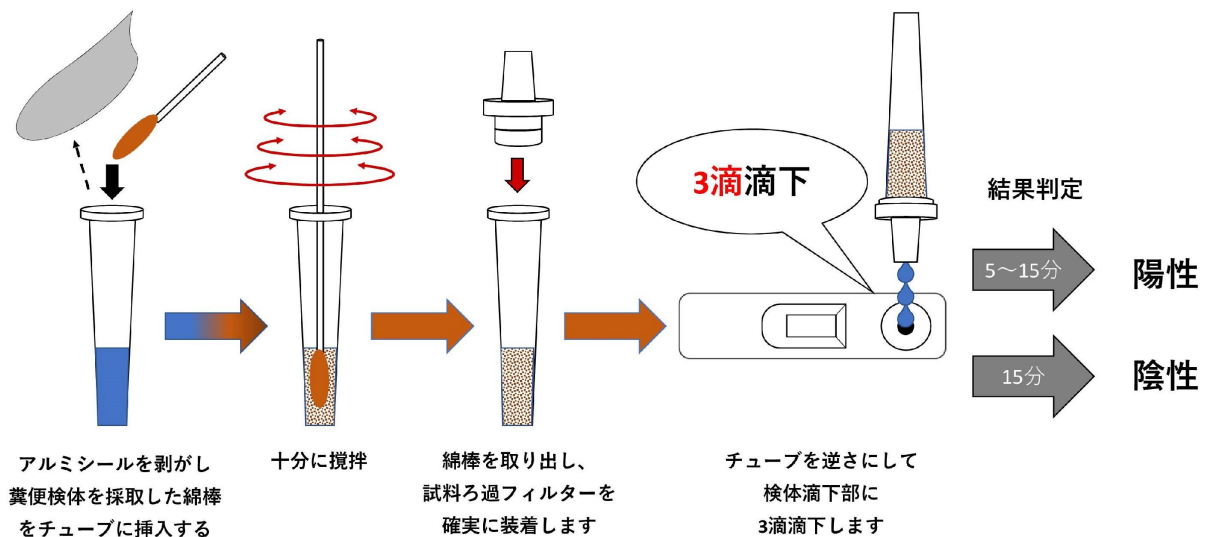

■綿棒包装形態の変更

変更前	変更後
10本包装	5本包装×2（計10本）

[変更した製品の出荷時期及び Lot No.]

出荷予定時期：平成30年4月～

変更品 Lot No. : NR18237～


※現行品の在庫状況によっては、出荷開始時期が前後する可能性があります。

[対象製品]

カタログ番号	製品名	包装
IPL0001	I Pライン® デュオ「ノロ・ロタ」	10回用

以上

製造発売元

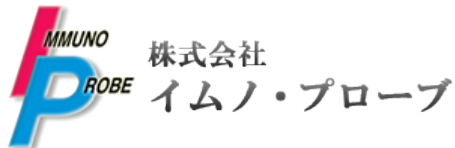

〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形 1331 番地 3

TEL 0493 (62) 6923 FAX 0493 (62) 9477